

Behandlare: Sample Report

Patient: Kön:

Ålder:

Referensnummer US: Datum för provtagning:

Typ av prov: Serumprov

Födelsedatum:

Mottagit:


Färdig:

IgA ☐
IgG ☐


CLIA #: 50D0965661

COLA accredited


Mjolkprodukter

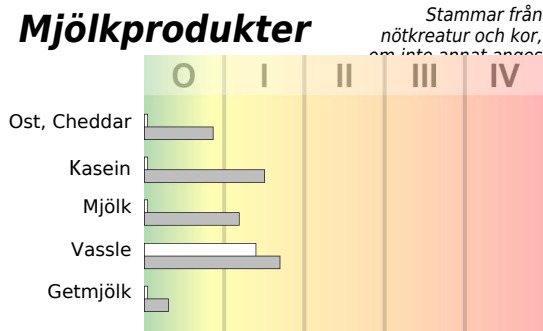


Kött / fågel / ägg

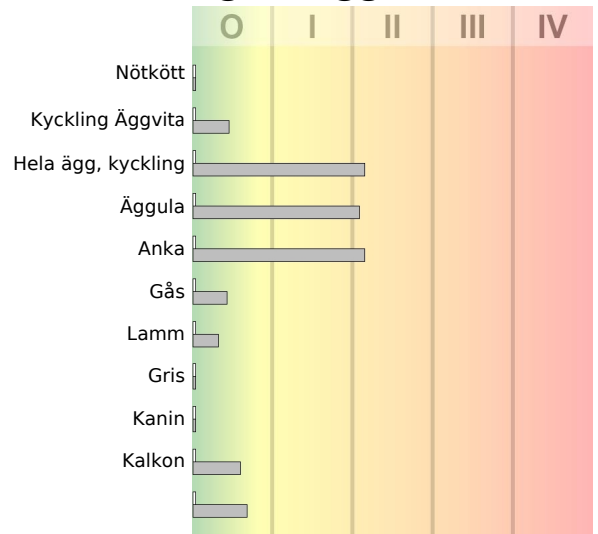

Fisk / skaldjur

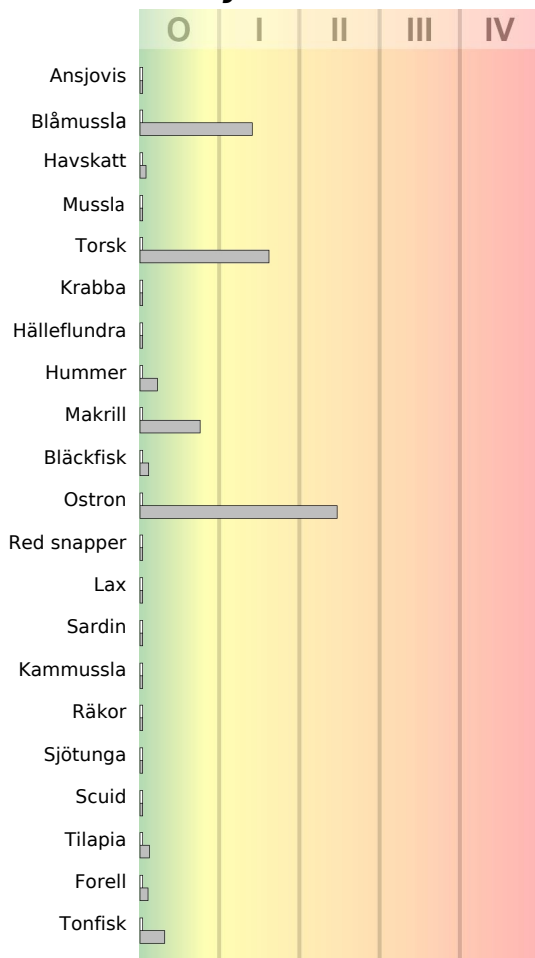

Kryddor

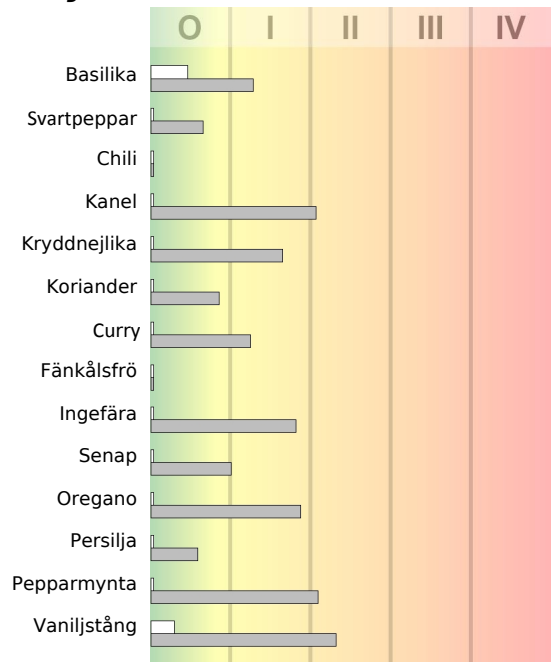

© US BioTek Laboratories

Reaktionsgrad

Director: Stephen Markus, MD

	O	I	II	III	IV
IgA (mg/L)	<1.95	≥1.95-3.90	>3.90-15.60	>15.60-29.90	>29.90
IgG (mg/L)	<2.50	≥2.50-5.00	>5.00-20.30	>20.30-47.10	>47.10
IgG4 (mg/L)	<1.20	≥1.20-4.70	>4.70-18.80	>18.80-37.50	>37.50
	Inte hittat	Låg	Moderat	Hög	Mycket hög

US Biotek Laboratories' egna ELISA-analyser är utformade för att bestämma den specifika totala IgG (klasser 1, 2, 3, 4) och IgA (klasser 1, 2)-antikroppar. Klassificeringen från 0 till IV representerar nivåerna av IgG och / eller IgA-antikroppar, som detekterades genom spektrofotometrisk analys. Antigenerna på panelen kan ändras utan föregående meddelande. Referensområden uppdateras med jämna mellanrum. Detta test utvecklades och dess egenskaper bestäms av US Biotek Laboratories, LLC, 16020 Linden Ave N, Shoreline, WA 98133, USA. Testet är inte klarerad eller godkänd av US Food and Drug Administration.

Behandlare: Sample Report

Patient: Kön:

Ålder:

Referensnummer US: Datum för provtagning:


Typ av prov: Serumprov
Mottagit: Färdig:

Födelsedatum:


IgA ☐
IgG ☐

CLIA #: 50D0965661
COLA accredited

Bönor/nötter

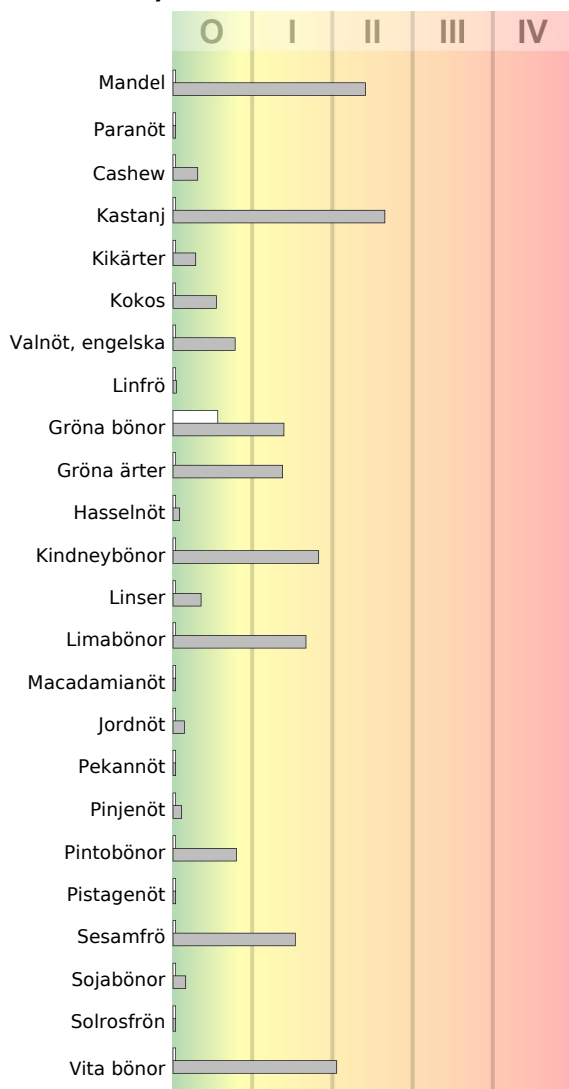

Grönsaker

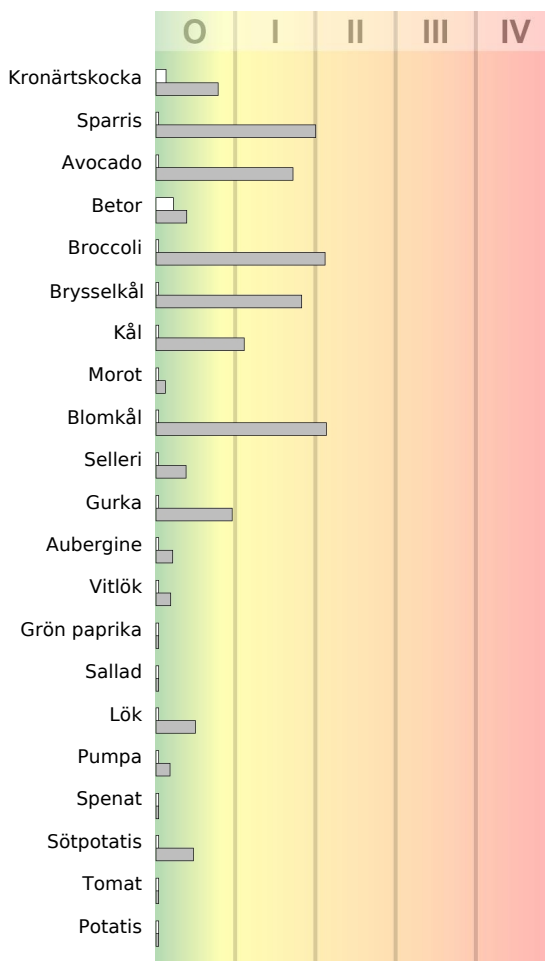

© US BioTek Laboratories

Reaktionsgrad

Director: Stephen Markus, MD

	O	I	II	III	IV
IgA (mg/L)	<1.95	≥1.95-3.90	>3.90-15.60	>15.60-29.90	>29.90
IgG (mg/L)	<2.50	≥2.50-5.00	>5.00-20.30	>20.30-47.10	>47.10
IgG4 (mg/L)	<1.20	≥1.20-4.70	>4.70-18.80	>18.80-37.50	>37.50
	Inte hittat	Låg	Moderat	Hög	Mycket hög

US Biotek Laboratories' egna ELISA-analyser är utformade för att bestämma den specifika totala IgG (klasser 1, 2, 3, 4) och IgA (klasser 1, 2)-antikroppar. Klassificeringen från 0 till IV representerar nivåerna av IgG och / eller IgA-antikroppar, som detekterades genom spektrofotometrisk analys. Antigenerna på panelen kan ändras utan föregående meddelande. Referensområden uppdateras med jämna mellanrum. Detta test utvecklades och dess egenskaper bestäms av US Biotek Laboratories, LLC, 16020 Linden Ave N, Shoreline, WA 98133, USA. Testet är inte klarerad eller godkänd av US Food and Drug Administration.

Behandlare: Sample Report

Patient:

Kön:

Ålder:

Referensnummer US: Datum för provtagning:

Typ av prov: Serumprov

Mottagit:

Färdig:

Födelsedatum:


IgA

IgG


CLIA #: 50D0965661

COLA accredited


Frukt

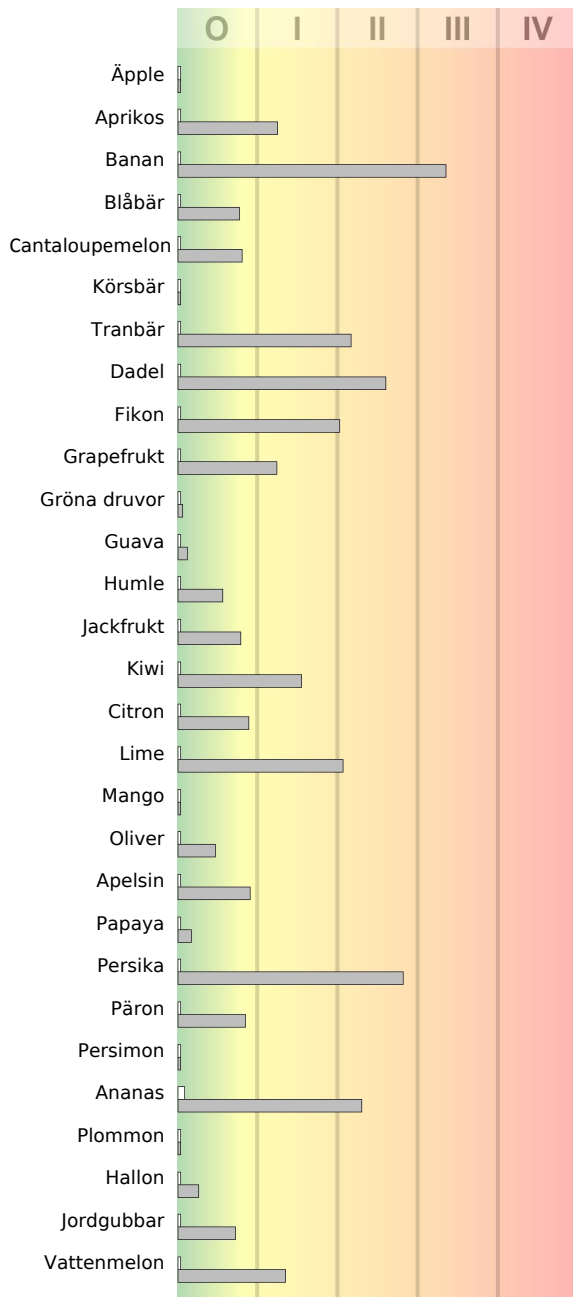

Diverse

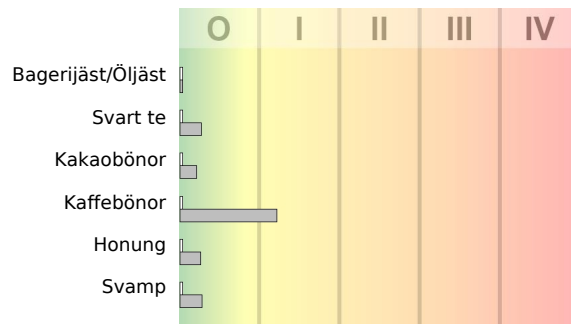

Säd

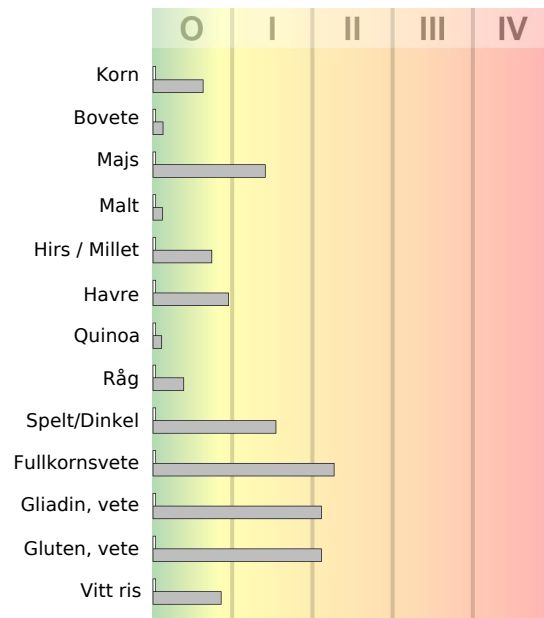

© US BioTek Laboratories

Reaktionsgrad

Director: Stephen Markus, MD

	O	I	II	III	IV
IgA (mg/L)	<1.95	≥1.95-3.90	>3.90-15.60	>15.60-29.90	>29.90
IgG (mg/L)	<2.50	≥2.50-5.00	>5.00-20.30	>20.30-47.10	>47.10
IgG4 (mg/L)	<1.20	≥1.20-4.70	>4.70-18.80	>18.80-37.50	>37.50
	Inte hittat	Låg	Moderat	Hög	Mycket hög

US Biotek Laboratories' egna ELISA-analyser är utformade för att bestämma den specifika totala IgG (klasser 1, 2, 3, 4) och IgA (klasser 1, 2)-antikroppar. Klassificeringen från 0 till IV representerar nivåerna av IgG och / eller IgA-antikroppar, som detekterades genom spektrofotometrisk analys. Antigenerna på panelen kan ändras utan föregående meddelande. Referensområden uppdateras med jämna mellanrum. Detta test utvecklades och dess egenskaper bestäms av US Biotek Laboratories, LLC, 16020 Linden Ave N, Shoreline, WA 98133, USA. Testet är inte klarerat eller godkänd av US Food and Drug Administration.